

光輝尽性蛍光板 70038000

レジウスプレート RP-3T 一般医療機器

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

支持体に光輝尽性蛍光体を塗布したシート状レジウスプレート RP-3T (以下 RP という) です。

2. 原理

RP 中の光輝尽性蛍光体にX線が照射されると、光輝尽性蛍光体はX線のエネルギーを吸収します。ダイレクトディジタイザ DD-741 (以下 REGIUS MODEL 170 という) 又はダイレクトディジタイザ DD-941 (以下 REGIUS MODEL 190 という) のレーザー光によって光輝尽性蛍光体に蓄積しているX線画像データを読み取ります。

【使用目的、効能又は効果】

1. RP とはX線エネルギーを貯え、光を当てると蛍光を発光するシートをいいます。

2. RP の使用目的

RP-3T は長尺撮影用として使用します。

【操作方法又は使用方法等】

1. RP を撮影目的に応じてレジウスカセッテ RC-110T (以下 R カセッテ という) へ取り付けます。

2. 撮影を実施します。

3. 撮影の終了した R カセッテをスタッカ一部から挿入し、それぞれの RP に蓄積された X 線画像データを REGIUS MODEL 170 又は REGIUS MODEL 190 のレーザー光で読み取ります。

【使用上の注意】

1. RP は水等がかからない場所で使用すること。

2. RP に湿気、水分を付着させないよう、又異物など R カセッテ内に入らないように注意して取り扱うこと。

3. RP の装填／取り出し時に、RP の蛍光面を損傷しないように注意すること。

4. RP の蛍光面にマジックペン、ボールペン、鉛筆などの筆記具で書き込まないこと。

5. RP は 10~30°C、80%RH 以下 (結露なし) の条件下で使用すること。

6. RP は子供の手の届かないところで使用、保管すること。

7. RP に折れ、キズ、変形等が発生したり、変色が生じたりした場合には、新品の RP に交換すること。

8. 分解した製品、あるいは何らかの異常により保護層の一部、あるいは全部が剥がれるなどして光輝尽性蛍光体が露出している製品は直ちに使用を中止すること。

9. RP を分解しないこと。光輝尽性蛍光体に触れたり、飲み込んだりすると危険である。飲み込んだ時および目にに入った時には、直ちに次の処置を行うこと。

①飲み込んだ時は、直ちに医師の診断を受けること。

②目にに入った時は目を傷めることがあるので、こするにすぐにきれいな流水で洗い流し、その後医師の診断を受けること。

③皮膚に直接ついた時は、きれいな水で充分に洗い流すこと。

10. RP のクリーニングを行う時には、次の注意事項を必ず守ること。

①カセッテを解放して RP 面を明所で扱う際はできるだけ速やかに行い、太陽光、紫外線、各種放射線があたる場所、および蛍光灯下での長時間の放置を避けること。

②RP にキズをつけたり、変形させたりしないように注意すること。

③水で湿らせ汚れを拭き取ることは絶対にしないこと。

11. クリーニングで使用する無水エタノールは、化学薬品である。薬品メーカーの取扱注意事項を守ること。

12. RP を廃棄する際は、産業廃棄物として必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【貯蔵方法及び有効期間等】

1. RP の梱包開封後は以下の点に注意の上、所定の条件下で使用、保管してください。

①温湿度条件

・温度 : 10~30°C

・湿度 : 80%RH 以下 (結露無きこと)

②開封後の RP は必ず R カセッテに収納して使用、保管してください。

③太陽光、紫外光、各種放射線があたる場所および、蛍光灯下での長時間の放置は避けてください。

2. 耐用期間 (自主基準)

耐用期間は、クリーニングを行った上で、キズ、折れ、変形、汚れ、変色や感度低下等により、診断画像に劣化をきたすまでとし、このような場合には新品の RP に交換してください。

【保守点検に係る事項】

1. RP の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。

2. 使用者による日常および定期点検を必ず行ってください。

(1) クリーニング


RP の蛍光体表面にはこり等が付着し、画像故障の原因となることがありますので、1 週間に 1 度、RP のクリーニングを行ってください。

注意 : クリーニングは直射太陽光、紫外光、各種放射線のあたらない、平坦な場所で速やかに行うこと。

注意 : クリーニング等、カセッテを解放して RP 面を明所で扱う際はできるだけ速やかに行い、太陽光、紫外光、各種放射線があたる場所、および蛍光灯下での長時間の放置を避けること。


**注意: RP はクリーニング後、必ず REGIUS MODEL 170
又は REGIUS MODEL 190 にて RP の消去を行
うこと。**

①開閉ロックを解除します。



②カセット全体を持ち反転させ、フロント板を外
します。

**注意 : フロント板を外す際は、下図の様に必ずバ
ック板を下にし、フロント板を上へ水平に
持ち上げること。**



③RP 表面に付着している繊維、ゴミ等をプロワー
で吹き払います。汚れ等は柔らかい不織布で、
軽く乾拭きします。乾拭きしても汚れが落ちな
い場合は、無水エタノールを少し湿らせて軽く
拭き取ります。

**注意 : 水で湿らせて汚れを取ることは、絶対に行
わないこと。**


**注意 : 力の入れすぎによるキズつき、変形等に注
意すること。**

**注意 : クリーニングで使用する無水エタノールは、
化学薬品です。薬品メーカーの取扱注意事
項を守ること。**

注意 : 無水エタノールをつけすぎないこと。



④フロント板を元に戻し、カセット全体を持ち反
転させ、R カセットの開閉ロックを閉めます。

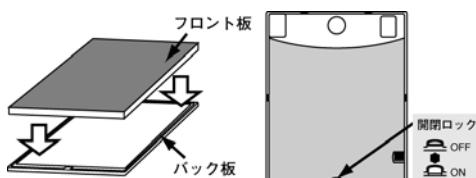

(2)RP に蓄積された不要な画像情報を完全に除去する
ために、1週間に1度、RP の消去処理を行ってく
ださい。

(3)保護膜のキズおよび破れの有無
RP 保護膜にキズおよび破れ等がないか確認してく
ださい。キズおよび破れ等が見つかった場合は、新
品と交換してください。

【包装】

品目、サイズはそれぞれの商品の個包装上に明記して
あります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 : コニカミノルタエムジー株式会社

住 所 : 〒191-8511

東京都日野市さくら町1番地

電 話 番 号 : 042-589-8421

製造業者名 : コニカミノルタエムジー株式会社

コニカミノルタ東京サイト日野

住 所 : 〒191-8511

東京都日野市さくら町1番地

電 話 番 号 : 042-589-8171